AGITEST™ NerVous Necrosis Virus (NNV) 取扱説明書

【製品】

ワンステップスピードウイルス検査試薬

「One-Step Rapid Test(NNV)」

【対象魚】

ハタ、バラムンダ、カンパチ、ヒラメ、フエダイ、スズキ、ベニザケ、鯛、カレイ、スギ

【製品内容】

①試験紙 Rapid Test Card

②0.5ml 緩衝液入り、チューブ

③使い捨てピペット

④使い捨てすり潰し棒

【試料調整】

①サンプル採取：Ⅰ～Ⅲのいずれかを選択

[Ⅰ]小さな幼魚（稚魚）（1インチ以下の魚）の場合：頭部もしくは、魚全体を採取してください。 ※1インチ＝2.54cm

[Ⅱ]小魚（1インチ以上の魚）の場合：眼球（1こ）をサンプルとして採取してください。

[Ⅲ]血液サンプルの場合：1.5ml を採取してください。採取後は、遠心分離機（3500rpm）を5分間かけてください。0.5ml の血清をサンプルとして使用します。

②試料調整

「①」で採取したサンプルを緩衝液 0.5ml の入ったチューブに入れ、同封のすり潰し棒を使いサンプルを均等に粉砕してください。

同封のピペットを使い、上積み液を採取してください。

※血液サンプルの場合は、血清を採取してください。

【試験方法】

①試験紙（Rapid Test Card）を取り出し、サンプルゾーンへ試料サンプルを3～4滴を滴下してください。（※一滴ずつゆっくり加えてください。）

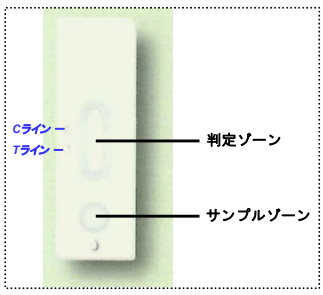

②15分間静置してください。

【判定方法】

赤いラインの発現で判定を行います。

- 赤いラインが1本の場合は、陰性（NNV に感染している疑いがないこと）を示します。
- 2本の赤いラインが発現した場合は、陽性（NNV に感染している可能性があること）を示します。

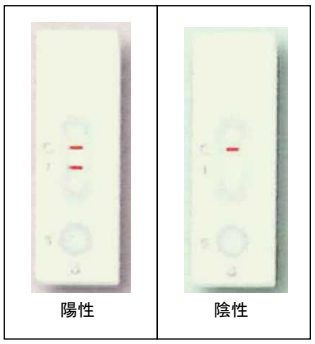

結果判定の見方

((注 意))

※ 赤いラインが1本も発現しない場合は、試験が失敗しているため、新しい検査試薬で再試験をしてください。

※ 最適な結果を得るために、判定はサンプルゾーンへ試料サンプルを3～4滴を滴下後 15～30 分の間に行ってください。

※ 本キットは、定性試験となります。ウイルスの感染度合いや潜伏量を測定（定量）することはできません。T ラインに、若干でも赤いラインが発現した場合は、陽性（ウイルス感染の疑いあり）となります。

※ C ラインの赤いラインが極めて薄い場合は、試験に失敗している可能性がありますので、再試験をおこなってください。

【取り扱い上の注意】

・検査試薬を保管する際は、直射日光から避けて4℃で保管してください。

・使用期限は製品の包装に記載してあります。使用期限を過ぎたものは使用しないでください。

・緩衝液あるいは試験紙を他の試験キットに使用しないでください。

・ご使用後は、手をよく洗ってください。

・万が一、試薬が目に入ったり、飲み込んでしまった場合は、直ちに医師の診断を受けてください。

・試験キットを再利用しないでください。

〔商品に関するお問い合わせ〕

（受付時間：午前9:00 から午後5:00 まで（土日・祝日を除きます））

●販売元：善ケミカル株式会社

電話：03-3839-5861 ／ FAX：03-3839-5877

E-mail：info@zenchem.com